

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę materiałów operacyjnych – nr sprawy: 21/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

**Pytanie 1**  
**Pakiet 30**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii stawu biodrowego o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
  - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
  - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
  - 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
  - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
  - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 1**  
**Pakiet 30**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
  - 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x150cm
  - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33x110cm
  - 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm
  - 1 serweta wzmocniona 200x240 cm z wycięciem "U" 10x80cm
  - 1 serweta samoprzylepna 175x260cm (ekran anestezyjologiczny)
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego dołączony materiał wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej (spunbond)-gramatura materiału w obszarze wzmocnionym: 100 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 1**  
**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 4 ręczniki 30 x 40 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm z miękkiej włókniny
- 1 serweta do cięcia cesarskiego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 260/200 cm x 335cm, z otworem 27 x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 14 x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny oraz osłoną podpórek kończyn górnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale otwór musi być w kształcie gruszki z folią chirurgiczną.

#### **Pytanie 2**

##### **Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:

-1 serweta ginekologiczna z workiem na płyny 230x240/260 cm z oknem 10 x 15 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne

-1 serweta przylepna do osłonięcia odbytu 50x50cm

-1 taśma samoprzylepna 9x50cm

-2 ręczniki celulozowe

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 3**

##### **Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:

-1 serweta 150x190cm na stół instrumentariuszki

-1 serweta na stolik Mayo 80x145cm

-1 serweta ginekologiczna z workiem na płyny 230x240/260 cm z oknem 10 x 15 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne

-1 serweta przylepna do osłonięcia odbytu 50x50cm

-1 taśma samoprzylepna 9x50cm

-2 ręczniki celulozowe

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczywym o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta do zabiegów brzuszno-kroczywym 230 cm x 302 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem w obszarze jamy brzusznej 28 cm x 32 cm oraz otworem w okolicy krocza 10 cm x 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm

1 osłona na kamerę 13 x 250 cm, składana rewersowo

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta na kończynę 280 x 200 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 6**

##### **Pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 7**

##### **Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 8**

##### **Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120x140cm

1 serweta na kończynę dłoń/stopa 200x300cm dwuwarstwowa, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 9**

##### **Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna posiada wzmocnienie w rozmiarze 100x50cm (+/-1cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 10**

##### **Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm

1 serweta operacyjna 150 x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta na kończynę 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego dołączony materiał wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej (spunbond)- gramatura materiału w obszarze wzmocnionym: 100 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 11**

##### **Pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta ma otwór samouszczelniający 7 cm izamiast uchwytu velcrojest organizator przewodów w postaci taśmy samoprzylepnej, a serweta pod kończynę ma rozmiar 150 x 150 cm?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Dodatkowo w obszarze pola

operacyjnego dołączony materiał wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej (spunbond)-  
gramatura materiału w obszarze wzmocnionym: 100 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cmz paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15  
cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.  
Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet,  
polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu  
podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cmz dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i  
hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

**Pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i  
hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp.: Należy zaferować zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16**

**Pakiet 20**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu o składzie włóknina 30g/m<sup>2</sup> i folia PE 20µm? Pozostałe  
parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Należy zaferować zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 17


#### Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia w części przedniej i na rękawach o gramaturze 28g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 1 zestaw do cięcia cesarskiego posiadający w swoim składzie główną serwetę: 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem:



250x315cm

1 szt./pos./un.

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale otwór musi posiadać kształt gruszki z folią chirurgiczną.

#### Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 pozycji nr 1 zestaw do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzyklepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm



290x312cm

1 szt./pos./un.



140x190cm

1 szt./pos./un.



30x40cm

1 szt./pos./un.



75x90cm

1 szt./pos./un.



9x50cm



1 szt./pos./un.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 pozycji nr 2 zestaw do operacji brzuszno-kroczywych o następującym składzie:


- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x85cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta brzuszno-kroczykowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przyklepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzyklepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm zabezpieczone klapką otoczone wzmocnieniem oraz 3. uchwyty ( typu "rzep") do mocowania kabli i drenów
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm



Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 pozycji nr 1 zestaw do operacji laparoskopowych posiadający w swoim składzie główną serwetę: 1 serwetę o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm






Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 pozycji nr 2 zestaw do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm ze wzmocnieniem,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm.



Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 6



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 10 pozycji nr 1 zestaw uniwersalny który w swoim składzie w miejsce 1 serwety operacyjnej z przylepcem (min.180 x 240 cm) posiada 1 serwetę operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150 cm x 240 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ. Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 11 pozycji nr 1 zestaw uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna 170x175cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 11 pozycji nr 1 zestaw uniwersalny który w swoim składzie w miejsce 1 serwety operacyjnej z przylepcem (min.180 x 240 cm) posiada 1 serwetę operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150 cm x 240 cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 12 pozycji nr 1 zestaw uniwersalny o następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna 170x175cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 10**


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 13 pozycji nr 1 zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych, który w swoim składzie w miejsce 1 serwety samoprzylepnej z wycięciem U (min.180 x 240 cm) posiada 1 serwetę samoprzylepną z wycięciem U w rozmiarze 150 cm x 240 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 14 pozycji nr 1 zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych o następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm ze wzmocnieniem,
- 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm,
- 1 serweta przylepna 200x240cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

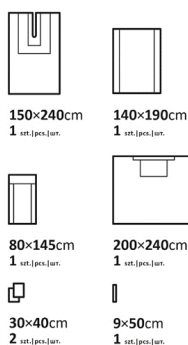

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 4 serwety operacyjnej w rozmiarze: 75cm x 75cm z otworem 6cm x 8cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 4 serwety operacyjnej w rozmiarze: 50cm x 60cm z otworem o średnicy 7cm.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 7 serwety operacyjnej w rozmiarze: 75cm x 75cm z otworem 6cm x 8cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 7 serwety operacyjnej w rozmiarze: 100cm x 150cm z otworem 9cm x 12cm.

Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

#### Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 8 serwety operacyjnej w rozmiarze: 120cm x 150cm z otworem o średnicy 7cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 18 pozycji nr 9 serwety operacyjnej w rozmiarze: 120cm x 80cm

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet nr 1

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> posiadającego w swoim składzie serwetę główną z torbą na płyny oraz oknem owalnym 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną? Pozostałe parametry i skład bez zmian .

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale otwór musi posiadać kształt gruszki z folią chirurgiczną.

#### Pakiet nr 3

2. **Poz. nr 1-2** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?  
Odp.Zamawiający dopuszcza.
3. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów ( min. 45 x 60 cm) i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm



1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm  
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm  
1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

4. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno- kroczo-  
wych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
1 serweta brzuszno-kroczo- z padami chłonnymi (otwory owalne 19 x 29 cm i 9 x 12 cm z klapą)  
230 x 250 cm  
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 6**

5. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii, w którym  
otwór w serwecie laparoskopowej ma kształt prostokąta? Pozostałe parametry i skład minimalny bez  
zmian  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 7**

6. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoń/ stopa posiadającego w  
swoim składzie serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160 cm? Pozostałe parametry  
i skład minimalny bez zmian.  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 10**

7. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu  
2- warstwowego o gramaturze min 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi o gramaturze min.  
110 g/m<sup>2</sup>, zawierającego w swoim składzie serwetę operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150 x 240  
cm ( w miejsce 180 x 240cm)? Pozostałe parametry i skład minimalny bez zmian  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 11**

8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zawierającego w swoim  
składzie serwetę operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150 x 240 cm ( w miejsce 180 x 240cm)?  
Pozostałe parametry i skład minimalny bez zmian  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 12**

9. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:  
  
1 serweta na stół narzędziowy 150 x 100 cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne 170 x 175 cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 14**

10. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żyłaków posiadającego w  
swoim składzie serwetę samoprzylepną w rozmiarze 170 x 250 cm ( w miejsce 180 x 200 cm )? Po-  
zostałe parametry i skład minimalny bez zmian.  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 18**

11. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadającej otwór o średnicy  
7 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**12. Poz. nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm lub serwety w rozmiarze 45 x 75 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu?

Odp.Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu.

**13. Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet nr 19

**14. Poz. 1-7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**15. Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 100 x 90 cm lub 150 x 175 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza zaoferowania serwety w rozmiarze 150x175 cm.

**16. Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**17. Poz. nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**18. Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**19. Poz. nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 200 cm lub 170 x 300 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza zaoferowania serwety w rozmiarze 170x300 cm.

#### Pakiet nr 20

**20.** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet nr 24

**21.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup> lub z włókniny typu SMS o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>.

#### Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale otwór musi posiadać kształt gruszki z folią chirurgiczną.

**Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów, z organizatorami przewodów	230cm x 320cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	4 szt.
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	3 szt.
elastyczna osłona na kończynę	22cm x 75cm	1 szt.
wzmocniona osłona na stolik Mayo	80cm x 145cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	2 szt.

Serweta 230x320cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 6 poz. 1**

[www.zoz.wodzislav.pl](http://www.zoz.wodzislav.pl)

adres e- mail: [przetargi@zoz.wodzislav.pl](mailto:przetargi@zoz.wodzislav.pl) [stachniuke@zoz.wodzislav.pl](mailto:stachniuke@zoz.wodzislav.pl)

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 300cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Z dołączoną osobno sterylnie zapakowaną serwetą na stolik Mayo i z dołączonymi 2 szt osobno sterylnie zapakowanymi ręcznikami pakowanymi pojedynczo.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta wzmocniona, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm, z organizatorami przewodów	150cm x 180cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.

serweta 150x180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Z osobno dołączonymi 2 szt sterylnie zapakowanymi ręcznikami włókninowymi pakowanymi pojedynczo w rozmiarze 40x40 cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odp.Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta samoprzylepna	150cm x 240cm	1 szt.
serweta samoprzylepna	180cm x 180cm	1 szt.
serweta samoprzylepna	75cm x 90cm	2 szt.
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	4 szt.
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	1 szt.
wzmocniona osłona na stolik Mayo	80cm x 145cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.

Serweta 150x240 i 180x180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.

Odp.Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> .

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> .

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
--



POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> .
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> .

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną taśmą przylepną w rozmiarze 10x50cm.  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> .
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> .

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną serwetą nieprzylepną w rozmiarze 150x210cm  
Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
2 x zaciskacz do pępowiny

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 17 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 17 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń do przechwytywania płynów samoprzylepną sterylną w rozmiarze 50x60cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.



**Pakiet 17 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie koca samoogrzewającego do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet 17 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na głowicę 16x250cm lub w rozmiarze 14x250cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza osłonę na głowicę 16x250cm.

**Pakiet 17 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm lub 30x80cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę 35 x 120 cm.cm.

**Pakiet 17 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą przyklepną? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie dołączenia drugiej osobno sterylnie zapakowanej taśmy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.




**Pakiet 17 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm 2 warstwowy z pulpy celulozowej laminowanej wzmocniony 48 nitkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 17 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C o składzie:

	rozmiar	ilosc
	100cm x 160cm	
	80cm x 150cm	1 zestaw
	3x100cm	
	100x160cm	1szt./pc.
	80x150cm	1szt./pc.
	3x100cm	2szt./pcs

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 17 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne włókninowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 17 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o parametrach:

Torebka na płyny w kształcie stożka. Torebka na płyny z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> w kształcie stożka o wym. 50x50cm. Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej, wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi dopasowanie drenów o różnej średnicy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 17 poz. 18-19**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tuneli włókninowych do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet 18 poz. 1-10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwowe (włóknina + laminat) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o wymiarze 6x8cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 18 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm z przylepcem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 18 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 18 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 19 poz. 6-7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 6 i 7 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet 19 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS o gramaturze 51 g/m<sup>2</sup>, w polu krytycznym wzmocnienie z włókniny i laminatu., gramatura serwetę w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 19 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 19 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x280cm z otworem przyklepnym o średnicy 10cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 19 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm z przyklepcem?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 19 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x220cm z przyklepcem?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przyklepnym o średnicy 7cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przyklepnym o wymiarze 6x8cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę niejałową z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 23 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koszule przedoperacyjne w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 23 poz. 8**

Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze na buty czy np. klapki włókninowe jednorazowe?

Odp. TAK.

**Pakiet 23 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie lub klapki włókninowe jednorazowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 24 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 26 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 26 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej, wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> z możliwością wywinięcia.

Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 26 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką antypotną w części czołowej, wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, tylna część wydłużona ze ściągaczem.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 26 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki?

Odp.Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 26 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści maski zgodne z normą EN 14683 typ II R?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 26 poz. 7-8**

Czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji BFE na poziomie 99,88%?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 28, pakiet 29**

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów z kolorystyczną identyfikacją rozmiarów w postaci kolorowej lamówki (różne kolory lamówki w zależności od rozmiaru)? Rozwiązanie takie znacznie usprawnia dobór odpowiedniego rozmiaru.

Odp.Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Zapytanie I – dotyczy Pakietu nr 02**

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do zabiegów ginekologicznych z workiem zbierającym płyny o składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach krocza, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w sztywnik .....240/150x150 1
2. serweta chirurgiczna .....75x90 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....150x200 1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 03**

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach krocza, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w sztywnik .....240/150x150 1
2. serweta chirurgiczna .....75x90 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....150x200 1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaferowano zestaw do operacji brzuszno- kroczych o składzie:

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm ..... 180/270x220 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x180 1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

### Zapytanie III – dotyczy Pakietu nr 04

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaferowano zestaw do endoprotezy kolana, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63g/m<sup>2</sup> w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego 83g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej; nieprzemakalność 347cm/H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 112/108 kPa. Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o grubości 60 mikronów oraz wytrzymałości na rozerwanie 120kPa. Owinięcie zestawu wykonane z laminatu o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>. Serwety boczne o wymiarach 75x90 cm oraz serweta chirurgiczna 150x240 cm, pakowane osobno. Skład:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysokochłoną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów ..... 220x320 1
2. osłona na kończynę ..... 37x75 1
3. taśmy samoprzylepne ..... 9x49 4
4. ręczniki chłonne ..... 30x40 4
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem..... 2x15x40 1
6. osłona na stolik MAYO ..... 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaferowano zestaw do endoprotezy biodra wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60,6 g/m<sup>2</sup> w strefie mniej krytycznej oraz dodatkowej warstwy (trzeciej) o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej; nieprzemakalność w strefie krytycznej >140 cm/H<sub>2</sub>O. Serwety boczne posiadają wytrzymałość na rozerwanie na such/mokro 102/50 kPa. Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o grubości 60 mikronów oraz wytrzymałości na rozerwanie 120kPa. Owinięcie zestawu wykonane z laminatu o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>. Skład:

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

---

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP .....	230/300x330	1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną .....	75x75	2
3. serweta na stół .....	150x190	1
4. osłona na kończynę .....	32x120	1
5. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
6. ręczniki chłonne .....	18x25	4
7. wzmocniona osłona na stół MAYO .....	79x145	1
8. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Zapytanie IV – dotyczy Pakietu nr 08

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów .....	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stół MAYO .....	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Zapytanie V – dotyczy Pakietu nr 09

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do chirurgii ręki o składzie:

1. serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 3,5 cm), otoczonym warstwą chłonną wyposażona w dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP.....	150/370x280	1
2. osłona na stół MAYO.....	79x145	1
3. serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

#### Zapytanie VI – dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw uniwersalny o składzie:

1. serweta góra z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów .....	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej .....	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów .....	175x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.



### Zapytanie VII – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw uniwersalny o składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny .....	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....	175x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

### Zapytanie VIII – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw uniwersalny o składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny .....	200x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....	75x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....	180x175	1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x200	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

### Zapytanie IX – dotyczy Pakietu nr 13, 14

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych o składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów .....	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej .....	200x260	1
3. serweta chirurgiczna .....	100x150	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	2
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

### Zapytanie X – dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści aby serwety operacyjne zaoferowane w Pakiecie 18 poz. 2,3,4,6 posiadały etykietę zbudowaną z części nieusuwalnej, bez naklejki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

### Zapytanie XI – dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści aby pozycji 1 zaoferowano zestaw do zabiegów w chirurgii biodra o składzie:

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów .....	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej .....	200x260	1
3. serweta chirurgiczna .....	75x90	1
4. serweta na stół .....	150x190	1
5. osłona na kończybę .....	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
7. ręczniki chłonne .....	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo .....	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie XII – dotyczy Pakietu nr 01,04,07,08,09,10,11,13,14,29,30**

Czy Zamawiający dopuści aby zaferowane wyroby zapakowane były w opakowanie typu folia- folia?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 10 – obłożenia pola operacyjnego – uniwersalne I

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Zestawu operacyjnego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> w skład którego wchodzi:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 40 x 40

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 21 – serweta operacyjna niejałowa

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Serwety niejałowej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Serwety niejałowej o rozmiarze 200cm x 160cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 23 – odzież zabiegowa jednorazowa

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Fartucha zabiegowego w rozmiarze uniwersalnym.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania obuwia włókninowego j.u. z powłoką antypoślizgową dla bezpieczeństwa użytkownika.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 24 – ubrania dla chirurgów jednorazowe

Czy nie zaszła oczywista omyłka w opisie Kompletu chirurgicznego, i powinien brzmieć: Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

lub włókniny „spound bound” min. 65 g/m<sup>2</sup>, bez ściągaczy na nogawkach, krótki rękaw, rozmiary M, L, XL, XXL?

Odp. Nie zaszła pomyłka.

Dotyczy Części 25 – podkłady jednorazowe

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu z włókniny medycznej, rozmiar 200cm x 80 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Dotyczy wymagań SIWZ w zakresie obłożeń chirurgicznych:**

Czy Zamawiający dopuści, aby serwety dwuwarstwowe w obłożeniach były zbudowane z folii polietylenowo-polipropylenowej oraz z włókniny polipropylenowej, natomiast serwety trzywarstwowe z folii polietylenowo-polipropylenowej, z włókniny polipropylenowej oraz włókniny wiskozowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Dot. przedmiotu zamówienia:**

**PAKIET 03-OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO II-GINEKOLOGIA POZ.1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

SKŁAD	ILOŚĆ	ROZMIAR	KSZTAŁT OTWORU	ROZMIAR OTWORU
serweta z otworem i przylepcem	1	200x180	PROST.	20x10
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75		
pokrowiec na nogę	2	120x75		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**PAKIET 03-OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO II-GINEKOLOGIA POZ.2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

SKŁAD	ILOŚĆ		ROZMIAR
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszzeń na płyny	1	PE - 2K	42x35

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51  
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**08- obłożenia pola operacyjnego- dłoń stopa II:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

SKŁAD	ILOŚĆ	ROZMIAR	KSZTAŁT OTWORU	ROZMIAR OTWORU
serweta z elementem elastycznym i otworem	1	300x240	OKRĄG	4
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	4	40x20		

Gramatura serwet 73g/m<sup>2</sup>.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**10- obłożenie pola operacyjnego- uniwersalne I:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

SKŁAD	ILOŚĆ	ROZMIAR
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**11- obłożenie pola operacyjnego- uniwersalne II:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw gdzie w składzie zamiast serwety min. 180 x240cm jest serweta 150x240cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**19- serwety operacyjne jałowe min. 56g/m<sup>2</sup>:**

**Poz.5:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150 cm z przylepcem bez otworu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Poz.5:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90 cm z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz.6:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 240 x180cm z przylepcem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz.5 i 6:** Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to udział większej liczbie wykonawców i zaoferowanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**21- serweta operacyjna niejałowa:**

Pyt.1: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt.2: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200 x 180cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**24- ubrania dla chirurgów jednorazowe:**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**25- podkłady jednorazowe:**

Poz.1: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 210x 80 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**29- fartuchy chirurgiczne bawełnopodobne sterylne:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny celulozowo- poliestrowej o gramaturze 68g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Projekt umowy:**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

2. Zważywszy na treść § 2 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie wiadomo jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

3. Zważywszy, że § 8 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znana sytuacja ekonomiczno-finansowa Zamawiającego, jaka jest aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa Zamawiającego? Proszę o krótki opis.

Odp. Załącznik F01 za wrzesień 2016r.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

